Hygiène & Maintenance

iCare+

Automate nettoyeur-désinfecteur et lubrificateur pour instruments rotatifs et dynamiques

Tout instrument utilisé pour un soin dentaire se doit d'être parfaitement nettoyé, désinfecté et entretenu.
Conscient de ces nécessités dans le cadre de la pratique journalière de soins dentaires, et après de longues années d'études, NSK propose désormais une réponse simple et efficace grâce à l'iCare+.
L'iCare+ est un automate dédié au nettoyage et à la désinfection des mécanismes internes et tubulures ainsi que des surfaces externes des instruments dynamiques, grâce au déroulement de son action mécanique et chimique en plusieurs phases.
Il permet de nettoyer, désinfecter et lubrifier en profondeur 4 instruments mis en rotation, en même temps, en 14 minutes maximum.

Avantages :

- Simplicité ;
- Automatique ;
- Rapidité ;
- Efficacité ;
- Contrôle permanent des paramètres ;
- Traçabilité ;
- Validation des cycles ;
- Connexion universelle des instruments dynamiques ;
- Reconnaissance des instruments interne/externe ;
- Reproduction des cycles dans le temps.

L'intelligence au service de vos instruments

Intelligent, l'iCare+ détecte le type d'instrument inséré (spray interne/externe et sans spray) en cas de canaux bouchés ou d'erreur d'insertion effectués par le praticien afin de garantir l'efficacité des cycles. Lors des différents cycles, iCare+ déclenche la rotation des instruments et l'injection des produits de traitement sur l'ensemble des mécanismes internes et dans les tubulures des instruments pour les nettoyer et les désinfecter en profondeur. Simultanément, une pulvérisation sous pression permet le nettoyage et la désinfection des surfaces externes.
Chaque cycle respecte une durée étudiée en conformité avec les normes européennes EN ISO 15883/ 15883-5 pour garantir une efficacité optimale des produits n.clean et n.cid et un parfait traitement des instruments, en profondeur.

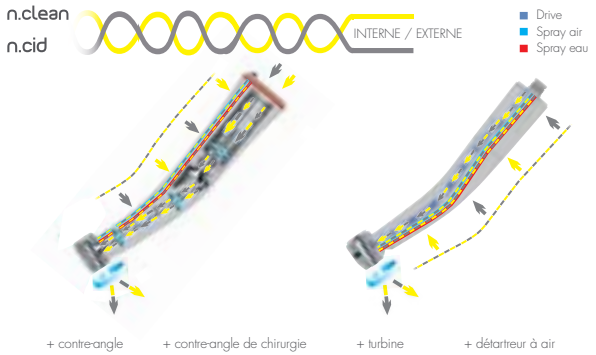

Sécurité

Les tests effectués par l'institut Dr Brill dans des conditions de souillures extrêmes des instruments (contenant du sang épariné de mouton, de la protamine, des bactéries et des levures) prouvent que les cycles de traitements de l'iCare+, en association avec les produits de nettoyage n.clean et de désinfection n.cid, assurent une efficacité de résultats prouvée.
Les tests de validation réalisés en Allemagne par ce laboratoire accrédité ont été faits selon les recommandations RKI (Robert Kock Institute) ainsi que la norme ISO 15883-5.

99,999% des bactéries éliminées

L'iCare+ permet de réduire les protéines très en dessous de la limite des 100 µg par instrument après traitement. La réduction du niveau de contamination microbienne (> à 5 Log Step) des instruments traités équivaut alors à plus de 99,999% des bactéries éliminées.

Répétabilité des cycles dans le temps garantie

Grâce à son système de contrôle interne par capteurs, iCare+ garantit que le cycle a été correctement reproduit dans le temps, pour chaque cycle, selon les paramètres définis en laboratoire. L'iCare+ est un dispositif médical disposant d'un protocole, d'une méthode d'analyse et d'une certification de résultat.

iCare+

Nettoyage et désinfection

Deux produits indissociables de l'iCare+

L'iCare+ fonctionne en association avec les produits n.clean et n.cid.
Ces produits sont spécialement développés pour l'instrumentation rotative et dynamique, en accord avec les protocoles validés en laboratoire.

Une association de produits certifiée

Des tests en laboratoire ont été menés avec les turbines, pièces à main et contre-angles de la gamme NSK ainsi qu'avec d'autres instruments de marques concurrentes : les résultats sont identiques et chaque fois valident un parfait traitement conforme aux normes en ISO 15883/ 15883-5.
Il est donc indispensable d'utiliser iCare+ en association avec les produits n.clean pour le nettoyage et n.cid pour la désinfection des instruments rotatifs, afin de garantir des résultats optimaux validés par les laboratoires.

Des actions ciblées

n.clean, la solution de nettoyage et de rinçage à effet détergent, bactériostatique et fongistatique. Elle empêche la fixation des protéines sur les surfaces internes et externes des instruments. La désinfection avant stérilisation se fait grâce à l'action du n.cid : solution de désinfection à effet bactéricide, fongicide et virucide* contre les virus enveloppés, ainsi que les Adeno virus non enveloppés.

* Bactéricide : TBC, MRSA. - Fongicide : Candida albicans - Virucide : HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza, H1N1, H5N1.

Traçabilité parfaite

Un logiciel interne de traçabilité

En complément du processus de validation intégré, un logiciel est aussi disponible pour consolider les données générées par iCare+.
Pour chaque cycle effectué, iCare+ génère un numéro de série.
Ainsi, une fois les données transférées dans le logiciel, le praticien peut compléter les informations des cycles par les numéros de série des instruments traités, les numéros de lots des produits utilisés, …etc., afin d'assurer une traçabilité totale des opérations réalisées.

Stockage des historiques

Pour assurer le suivi des traitements exécutés par iCare+, un port USB a été conçu afin de recueillir toutes les données (date, instruments sérialisés, ...etc.) sur une clé de stockage (non fournie avec l'appareil).

Une interface conviviale

Le praticien peut facilement gérer et ainsi avoir tout l'historique des cycles des instruments traités depuis une interface conviviale installée sur son ordinateur.

Hygiène et Maintenance

iCare+

Traite 4 instruments en 14 minutes !

Utilisation simple

L'avancement du processus est signalé grâce aux LED sur le panneau de contrôle et par l'éclairage interne de la chambre de traitement :

- Jaune pour le nettoyage ;
- Blanc pour la désinfection ;
- Bleu pour la lubrification ;
- En fin de cycle, lorsque la LED verte s'allume sur le panneau de contrôle, le praticien a l'assurance que les instruments ont bien été traités efficacement.

TRAITE 4 INSTRUMENTS
EN 14 MINUTES !

Nettoyage

Désinfection

Lubrification

Ensemble complet iCare+

Sortie rotation électrique pour 3 contre-angles
ou pièce à main et sortie rotation air pour 1 turbine
MODÈLE : **iCare + (230V)** RÉF : **S103001** € **5956,-**

Sortie rotation électrique pour 2 contre-angles
ou pièce à main et sortie rotation air pour 2 turbines
MODÈLE : **iCare + (230V)** RÉF : **S102001** **Prix sur demande**

Contenu :

- Unité iCare+ • Cordon d'alimentation
- Tube à air • CD mode d'emploi

Caractéristiques

• Tension d'alimentation CE	: AC 100_230V 50/60Hz
• Pression d'alimentation*	: 5 - 6,0 bars
• Capacité	: jusqu'à 4 instruments
• Poids net	: 14 kg
• Capacité du réservoir d'huile	: 500ml
• Capacité de l'emplacement pour le produit de nettoyage ou de désinfection	: 500ml

*Connection valable uniquement pour turbine Midwest 4 trous
*Pression d'alimentation nécessaire (5.0-6.0 Kgf/cm^2)

Adaptateurs iCare+

MODÈLE : Adaptateur PTL	RÉF : Z1127010	€ 149,5-	• Pour turbine NSK raccord PTL-CL-4HV-T
MODÈLE : Adaptateur KV	RÉF : Z1127011	€ 149,5-	• Pour turbine Kavo® pour raccord MULTIflex® LUX
MODÈLE : Adaptateur SR	RÉF : Z1127013	€ 132,-	• Pour turbine Sirona® pour raccord Sirona®
MODÈLE : Adaptateur WH	RÉF : Z1127012	€ 132,-	• Pour turbine W&H® pour raccord Roto Quick
MODÈLE : Adaptateur BA	RÉF : Z1127014	€ 132,-	• Pour turbine Bien-Air® pour raccord Unifix®

Merci de vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des accessoires.

Huile de maintenance et solutions

MODÈLE : **n.clean (6 bouteilles 500ml)**
RÉF : **ACL600** € **138,-**

MODÈLE : **n.cid (6 bouteilles 500ml)**
RÉF : **ACD600** € **155,-**

MODÈLE : **Huile de maintenance (1 bouteille 1L)**
RÉF : **Z016117** € **101,-**

iClave

Autoclave de classe B

La performance au service de la stérilisation des pièces à main, contre-angles et turbines.

Les systèmes de stérilisation NSK ont été conçus pour la stérilisation des instruments. Les systèmes d'expulsion forcée de l'air permettent à la vapeur saturée de pénétrer à l'intérieur des micro-mécanismes et de stériliser toutes les surfaces internes et externes des instruments. Grâce à l'extra-ordinaire précision du système de chauffage et à la suppression des écarts thermiques, les systèmes de stérilisation NSK permettent une stérilisation des instruments en toute sécurité, sous emballage ou non, sans risque de détérioration prématurée comme cela peut arriver avec des autoclaves de qualité médiocre. En conformité avec les dispositions des normes, le système iClave dispose de 2 programmes-test: Bowie & Dick et Vacuum test. Grâce à la puissante action fractionnée de la pompe, iClave passe avec succès le test hospitalier le plus exigeant (Helix test).

Avantages

- Triple sécurité de la porte
- Contrôle croisé des valeurs de pression et de température
- Stabilité maximale des paramètres
- Contrôle informatisé

NSK a élaboré un système de chauffage d'avant-garde, capable de contrôler de manière plus précise et homogène la température à l'intérieur de la chambre de stérilisation. 3 capteurs de température différents permettent de contrôler la température de la vapeur mais également la température superficielle et d'éviter ainsi les chocs thermiques lorsque les instruments se trouvent à proximité de la chambre. La chambre de stérilisation, réalisée en cuivre nickelé, a une conduction thermique supérieure à une chambre en acier et le contrôle est par conséquent plus précis et plus homogène. L'ensemble de ces composantes et leurs gestions par l'intermédiaire d'un logiciel extrêmement évolué permet d'obtenir des prestations supérieures.

Système pré et post vacuum

L'iClave dispose d'une pompe puissante pour l'expulsion de l'air avant la stérilisation et accomplit une action importante de ventilation à l'aide d'un filtre bactériologique et d'un système spécial de chauffage afin d'assurer un séchage parfait.

Volume utile de la chambre

Grâce au support enveloppant et à des plateaux percés, il est possible d'utiliser un plus grand volume de la chambre et par conséquent de stériliser une plus grande quantité d'instruments par rapport aux systèmes dotés de chambres semblables, munis de plateaux standards (+20%).

Panneau de commandes

L'iClave est totalement automatique et doté de programmes pré-réglés.

Il suffit de choisir le programme et d'appuyer sur START pour démarrer un cycle, l'appareil s'arrête automatiquement en fin de cycle. L'opérateur a toutefois la possibilité d'accéder à un menu de programmation grâce auquel il peut régler à son gré les paramètres pour garantir une flexibilité maximale.

L'autoclave est muni d'un compteur de cycles permettant de visualiser le nombre de cycles qui ont échoué et les dernières alarmes.

Un système avancé de mesure permet de contrôler la qualité de l'eau et de préserver le bon fonctionnement de l'autoclave.

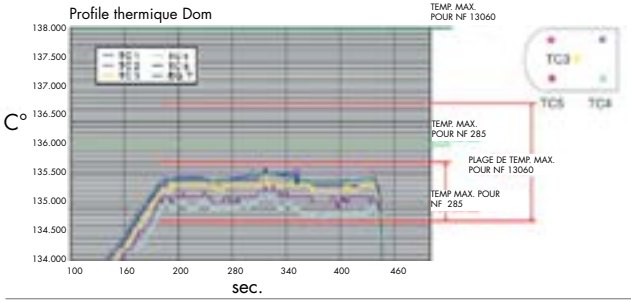

Système d'évaluation du processus

Le système d'évaluation du processus permet de garantir une stérilisation sûre. Le système se base sur le contrôle croisé des paramètres de pression et de température, il permet de garantir la qualité de la vapeur saturée et de mieux contrôler le bon fonctionnement du système de chauffage.

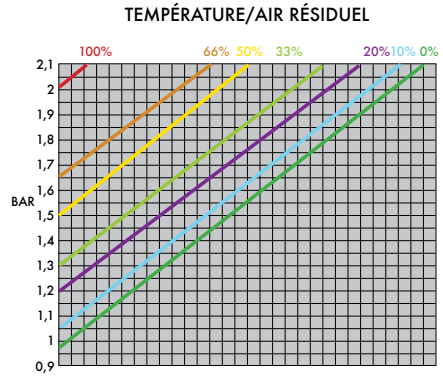

Caractéristiques

Dimensions externes (LxPxH)	443x562x428 mm	Chauffage différencié	•
Dimension de la cuve Ø	240x384 mm	Température avec décimales	•
Capacité de la cuve	18 l	Connexion à l'ordinateur - USB	•
Volume utile	17 l	Imprimante intégrée/externe optionnel	•
Poids net	55 kg	Doseur volumétrique	•
Absorption maximale	1.900 W	Contrôle de la qualité de l'eau	•
Absorption moyenne	800 W	Filtre bactériologique	•
Tension d'alimention CE	230 V - 50 Hz	Set up altitude	•
Porte à triple sécurité	•	Double reservoir	•
Système d'expulsion de l'air	Pompe à vide 1,3,4 vides	Autodiagnostic	•
Pompe de séchage	•	Compteur de cycles	•
Programmes	8	Entretien automatique	•
Bowie & Dick test	•	Indication de validation annuelle	•
Hélix test	•	Remplissage H2O supérieur et frontal	•
Test du vide	•	Filtre H2O accessible	•
Arrêt automatique - cycle nuit	•	Calibration par logiciel	•
Système d'évaluation du processus	•	Service après-vente par PC/modem	•
Résistances adhésives	•	Temps moyens de stérilisation*	19-32 min (1V)
Nr. Sondes de température	3		32-50 min (3V)
Nr. Sondes de pression	1	Classe selon le EN 13060	B

* Les temps peuvent êtres modifiés selon la quantité et le type de charge, la température au départ du cycle, la tension et l'état de l'entretien des composantes.

MODÈLE **Ensemble complet iClave avec imprimante** RÉF **A600000** € **6698,-**

MODÈLE **Ensemble complet iClave sans imprimante avec port USB** RÉF **A60000U** € **6895,-**

Contenu :

• Autoclave de Classe B • Filtre bactériologique • Filtre à eau
• 4 plateaux • 1 clé porte-plateaux
• Pastilles de nettoyage • Cordon secteur • Tuyau de vidange

Care3 Plus

Nettoie et lubrifie automatiquement

Un bon entretien régulier est essentiel pour assurer le bon fonctionnement et une longue durée d'utilisation de vos instruments rotatifs. NSK a conçu le Care3 Plus facile à utiliser pour faciliter l'entretien de vos turbines et contre-angles dans votre cabinet. Care3 Plus nettoie et lubrifie automatiquement jusqu'à 3 instruments à la fois, d'une simple pression sur un bouton. Les contre-angles et les turbines sont traités en profondeur au cours d'un cycle unique de deux minutes.

Care3 Plus peut être utilisé avec NSK & d'autres marques de turbines, de pièces à main et de contre- angles

Avantages

- Très facile à utiliser
- Rotation des instruments pendant le cycle
- Economique, efficace et rapide

Caractéristiques

- Une solution de maintenance qui vous préserve de tout problème
- Air filtré durant la rotation de l'instrument
- Indicateur du niveau de solution
- Nettoyage facile
- Système d'élimination de tous les résidus de solution
- Système de filtration

Système d'entretien rotatif

Un des plus grands avantages du système rotatif est sa capacité à pouvoir nettoyer et lubrifier. En effet, en laissant les instruments tourner pendant le traitement, la solution et l'huile peuvent être propagées dans tous les interstices de chaque instrument.

Contre-angles et Pièces à main

Les pièces à main et contre-angles incluent des mécanismes de changement de vitesse qui exigent une meilleure pénétration de la solution. C'est pourquoi le port de rotation de Care3 Plus fait tourner le mécanisme à l'intérieur de l'instrument, permettant une lubrification et un nettoyage efficaces et simultanés.

Turbines

Le composant le plus important de la turbine ainsi que tous les tuyaux d'air et d'eau sont soigneusement nettoyés et lubrifiés.

Le panneau de contrôle Care3+ est facile à comprendre et à utiliser.

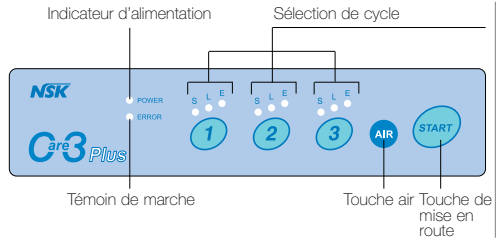

Choix entre trois cycles

S mode: Cycle court (Approx 35 secondes)
Pour les turbines (Approx 45 secondes)
L mode : Cycle long (Approx 45 secondes)
Pour les turbines et contre-angles
E mode:Cycle extra long (Approx 50 secondes)
Pour les contre-angles multiplicateurs et réducteurs

* Les chiffres entre parenthèses indiquent la période de nettoyage-lubrification pour un instrument.

Pack complet Care3 Plus

Sortie Rotation électrique pour contre-angle et pièce à main + double sortie Rotation air pour turbine

MODÈLE Care3 Plus Type C1 RÉF Y141204 € 2882,-

Double Rotation électrique pour contre-angle et pièce à main + sortie Rotation air pour turbine

MODÈLE Care3 Plus Type C2 RÉF Y141205 € 2882,-



Contenu
- Boîtier Care3 Plus • Cordon d'alimentation avec prise en L
- Huile d'entretien (1 litre) • Feuille d'absorption de l'huile
- Entonnoir de remplissage d'huile avec filtre
- Ensemble de filtre d'humidité • Tube air • Filtre à air

Caractéristiques

• Alimentation	: 230V 50/60Hz
• Pression de l'air	: 0.35-0.6 MPa (3.5-6 kgf/cm^2)
• Poids	: 7.1 kg (C1 type), 7.2 kg (C2 type)
• Dimensions	: L280 x D275 x H360 (mm)
• Capacité du réservoir de solution	: 350 mL

◆ Avec un réservoir complet, environ 3.500 pièces à main (mode S) sont nettoyées et lubrifiées.
*Se raccorde uniquement au type Midwest 4 trous
*Un tuyau est nécessaire pour l'air (3,5-6 kgf/cm2)

Care3 Plus Adaptateurs

MODÈLE Adaptateur type E*	RÉF Z280035	€ 129,-	• Pour accessoires toutes marques type E* & E LUX
MODÈLE Adaptateur PTL	RÉF Z257010	€ 129,-	• Pour turbines avec raccord PTL-CL-4HV-T
MODÈLE Adaptateur B2/M4	RÉF T904	€ 129,-	• Pour turbines Borden 2 voies
MODÈLE Adaptateur KV	RÉF Z257020	€ 129,-	• Pour turbines KaVo® raccord MULTIflex® LUX
MODÈLE Adaptateur SR	RÉF Z257023	€ 129,-	• Pour turbines Sirona® raccord Quick Coupling
MODÈLE Adaptateur WH	RÉF Z257021	€ 129,-	• Pour turbines W&H® avec raccord Roto Quick®
MODÈLE Adaptateur BA*	RÉF Z280022	€ 129,-	• Pour turbines Bien-Air® avec raccord Unifix®
MODÈLE Adaptateur F*	RÉF Z280042	€ 129,-	• Pour têtes ENDO-MATE TC2, DT/TASKAL Wizard/iSD900

* Pour Care3 Plus uniquement. Ne convient pas à Care3.
◆ Veuillez vous adresser à votre revendeur en ce qui concerne les adaptateurs, pour monter d'autres pièces à main du fabricant.

Huile de Maintenance

MODÈLE Huile de maintenance RÉF Z016117 € 101,-
(1 bouteille, 1 Litre)

MODÈLE Huile de maintenance RÉF Y900138 € 603,-
(Lot de 6 Bouteilles)

MODÈLE Ensemble filtre voile d'eau
RÉF Y900159 € 31,50
• Lot de 12 pièces

MODÈLE Feuilles d'absorption d'huile
RÉF Y900186 € 13,-
• Lot de 20 pièces

Les prix sont en TTC
*Type E : Conforme à la norme ISO3964.

Multi-Stands

Le support multiple NSK est le moyen le plus pratique d'organiser et de ranger les turbines et les contre-angles NSK. Stérilisable en autoclave à 135 °C.

MODÈLE Multi-Stand complet RÉF Z036 € 85,-
- Pour turbines CA et PAM
- 5 adaptateurs A
- 5 adaptateurs B
- 4 adaptateurs C

Supports instruments pour Multi-Stand

MODÈLE Adaptateur A	RÉF Z036201	€ 4,25	• Pour turbines et moteurs pneumatiques Phatelus
MODÈLE Adaptateur B	RÉF Z036202	€ 4,25	• Pour pièces à main de type E* et têtes à moteur pneumatique Phatelus
MODÈLE Adaptateur C	RÉF Z036203	€ 4,25	• Pour raccords Phatelus et Mach
MODÈLE Adaptateur type KV	RÉF Z036204	€ 4,25	• Pour KaVo® MULTIflex LUX®
MODÈLE Adaptateur type SR	RÉF Z036205	€ 4,25	• Pour Sirona® Quick Coupling
MODÈLE Adaptateur type WH	RÉF Z036207	€ 4,25	• Pour W&H® Roto Quick
MODÈLE Adaptateur type BA	RÉF Z036206	€ 4,25	• Pour Bien-Air® Unifix®
MODÈLE Adaptateur type F	RÉF Z036209	€ 4,25	• Pour têtes ENDO-MATE DT/TC2/ TASKAL Wizard/iSD900

PANA SPRAY Plus

PANA SPRAY Plus est un lubrifiant pour turbines et moteurs pneumatiques formulé spécialement, et très efficace.
L'utilisation fréquente de PANA SPRAY Plus garantira la performance et la longévité des turbines et moteurs pneumatiques.
Utilisez PANA SPRAY Plus avant chaque passage en autoclave.

MODÈLE **Pana Spray Plus** RÉF **Z182100** € **37,90-**

- Pour turbines et moteurs pneumatiques
- 480 mL • Lubrifiant contenant de l'alcool

PANA SPRAY Plus Package

MODÈLE **Pana Spray Plus** RÉF **Y900630** € **199,-**

- PANA SPRAY Plus Vendu par 6

Pochette absorbante de lubrifiant

Un moyen pratique d'empêcher le produit vaporisé de s'échapper dans l'environnement. Insérez tout simplement l'instrument dans la pochette d'absorption puis appliquez e lubrifiant en spray.

MODÈLE **Pochette absorbante de lubrifiant** RÉF **Y900084** € **73,-**

- vendues par 10

Embouts PANA SPRAY Plus 135°C



MODÈLE **Embout Phatelus** RÉF **P183090** € **13,50**

- Pour les turbines et les moteurs pneumatiques qui se fixent aux raccords Phatelus et Mach

MODÈLE **Embout KV** RÉF **Z090051** € **13,50**

- Pour KaVo® MULTIflex® LUX

MODÈLE **Embout SR** RÉF **Z090052** € **13,50**

- Pour raccord rapide Sirona®



MODÈLE **Embout WH** RÉF **Z090054** € **13,50**

- Pour W&H® Roto Quick

MODÈLE **EmboutBA** RÉF **Z090053** € **13,50**

- Pour Bien-Air® Unifix®

MODÈLE **Embout Têtes Phatelus** RÉF **M070090** € **13,50**

- Pour têtes Phatelus

* Utilisé fixé au-dessus de l'embout de spray Phatelus.

MODÈLE **Embout de type E** RÉF **Z019090** € **13,50**

- Pour accessoires de type E*

MODÈLE **Embout de type F** RÉF **Z256090** € **13,50**

- Pour têtes ENDO-MATE TC2, DT/TASKAL Wizard/iSD900

Manomètre multifonction

Destiné à mesurer la pression d'air et d'eau entrants, et si nécessaire, l'air sortant et l'air de refroidissement. Avec raccord MidWest 4 voies et Borden 2/3 voies.

MODÈLE **MG-4H** RÉF **Z109400** € **414,-**

- Pour Midwest 4 voies & raccord lumière

MODÈLE **MG-2/3H** RÉF **Z109200** € **414,-**

- Pour Borden 2/3 voies

Les prix sont en TTC

*Type E : Conforme à la norme ISO3964.

KaVo® and MULTIflex® LUX are registered trademarks of Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. Sirona® is a registered trademark of Sirona Dental Systems GmbH. W&H® is a registered trademark of W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Bien-Air® and Unifix® are registered trademarks of Bien-Air Dental S.A.

Pression pneumatique des instruments

Turbines		Pression d'air MPa (kgf/cm2)
	Ti-Max X	0.25~0.30 MPa (2.5~3.0 kgf/cm^2)
	Ti-Max X450L	
	S-Max M	0.20~0.25 MPa (2.0~2.5 kgf/cm^2)
	S-Max pico	
	Pana-Max / Pana-Max PLUS	0.2~0.25 MPa (2~2.5 kgf/cm^2)
	PANA-MAX 2	
	PRESTO AQUA LUX	0.25~0.30 MPa (2.5~3.0 kgf/cm^2)
	PRESTO AQUA II	
	PRESTO II	0.20~0.25 MPa (2.0~2.5 kgf/cm^2)
Moteurs pneumatiques		
	X205L	0.25~0.40 MPa (2.5~4.0 kgf/cm^2)
	M205/ IS-205	
	DYNALED M205LG	
	FX-205 FX-205m	
	Phatelus	0.25~0.30 MPa (2.5~3.0 kgf/cm^2)
Hygiène Buccale		
	Ti-Max S970	0.30 MPa (3.0 kgf/cm^2)
	AS2000	0.28 MPa (2.8 kgf/cm^2)
	Prophy-Mate neo	0.25~0.35 MPa (2.5~3.5 kgf/cm^2)
	Perio-Mate	0.27~0.40 MPa (2.7~4.0 kgf/cm^2)

HYGIÈNE ET MAINTENANCE NSK

Hygiène et Maintenance

APTICA plus B mini

Autoclave de classe B

Le premier autoclave rapide de classe B conçu pour la stérilisation des instruments rotatifs en un temps record.

Avantages

- Jusqu'à 17 instruments
- Consommation d'énergie très faible
- Stabilité des paramètres de pression et de température
- Validation des cycles

Rapide

APTICA plus B mini Premium Line stérilise en 12 mn (séchage inclus). Le cycle B (test hélix) est réalisé en moins de 18 mn (séchage inclus). Haute Performance APTICA plus B mini stérilise en une seule fois, 12 instruments rotatifs emballés et 17 en vrac.

Doux

Grâce à son système de chauffage de haute technologie, APTICA plus B mini évite les sauts thermiques et permet la stérilisation en douceur, sans endommager vos instruments.

La durabilité écologique

En dépit des cycles rapides, APTICA plus B mini a une consommation très faible. Le chauffage spécial lui permet d'économiser, énergie et eau. De ce fait, nous prenons soin de la planète.

Fiabilité

Grâce à cette avancée technologique et à l'utilisation de composants éprouvés depuis de nombreuses années, l' APTICA plus B mini est très fiable, même en utilisation intensive.

Flexibilité

Bien que conçu pour les dispositifs médicaux rotatifs, l'APTICA plus B mini est capable de stériliser tous types d'instruments conformément à la norme EN13060 des cycles B.

Validation

La stérilisation est effectuée en conformité avec la norme EN13060 et les cycles peuvent être facilement validés.